

Für den Fall, dass es mit unserem Kunden keine anderweitige Regelung gibt, wendet das Prüflaboratorium Qualicon die im folgenden erläuterte Entscheidungsregel, wenn notwendig an:
(In case there is no agreement with our customer that states differently, the test laboratory Qualicon is applying the following decision rule if necessary:)

Fall 1: „Messwert“ ≤ „Grenzwertes und „Messwert“ + Messungenauigkeit“ ≤ „Grenzwertes“

Case 1: „measured value“ ≤ „threshold“ and „measured value + uncertainty“ ≤ „threshold“

Fall 2: „Messwert“ > „Grenzwertes und „Messwert“ + Messungenauigkeit“ > „Grenzwertes“


Case 2: „measured value“ > „threshold“ and „measured value + uncertainty“ > „threshold“

Fall 3: „Messwert“ ≤ „Grenzwertes und „Messwert“ + Messungenauigkeit“ > „Grenzwertes“

Case 3: „measured value“ ≤ „threshold“ and „measured value + uncertainty“ > „threshold“

Fall 4: „Messwert“ > „Grenzwertes und „Messwert“ + Messungenauigkeit“ ≤ „Grenzwertes“

Case 4: „measured value“ > „threshold“ and „measured value + uncertainty“ ≤ „threshold“

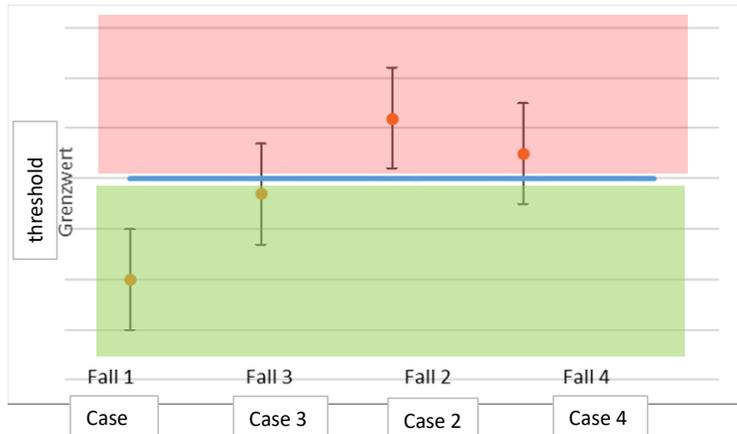

	Messwert + Messungenauigkeit ≤ Grenzwertes	(measured value + uncertainty ≤ threshold)	Messwert + Messungenauigkeit > Grenzwertes	(measured value + uncertainty > threshold)
Messwert (measured value) ≤ Grenzwert (threshold)	Ergebnis erfüllt (Fall 1)	(requirement fulfilled) (Case 1)	Ergebnis: erfüllt (Fall 3)	(requirement fulfilled) (Case 3)
Messwert (measured value) > Grenzwert (threshold)	Ergebnis : nicht erfüllt (Fall 4)	(requirement not fulfilled) (Case 4)	Ergebnis = nicht erfüllt (Fall 2)	(requirement not fulfilled) (Case 2)